

YZRXGK-2022122 号

扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备
采购项目
公开招标文件



采 购 人： 扬州市中心血站
采购代理机构： 扬州仁信工程管理有限公司
发 放 日 期： 2022 年 9 月 2 日

目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	8
第三章 合同条款及格式.....	20
第四章 项目需求	25
第五章 评标方法及评标标准	63
第六章 投标文件格式.....	66

疫情防控期间开评标现场说明

1、开标会由招标人或受委托的代理机构主持，邀请所有投标人参加，**每家供应商仅能派一名授权代表参加开标会**，委托代理人必须携带身份证原件到达开标现场，并配合做好相关询问记录。

2、各单位、企业应切实履行疫情防控责任，所派人员应为近期未去过疫情高危地区，未途经（或从外埠到、返后已按要求隔离符合最新防控政策，未出现任何症状）、身体健康且符合防控要求，因把关不严造成后果的，将上报有关部门追究责任。

3、各交易参与者应自行综合考虑疫情防控期间参与招投标活动的各种不利因素，如交通、住宿等，并做好应急预案，确保按时参加交易活动且自行承担相关责任，履行相关义务。

4、根据疫情防控工作要求，进入代理机构需进行身份核验，将“通信行程卡”、“健康码”查验和体温检测作为防控重要手段，严格开展“通信行程卡”、“健康码”人工查验工作。对显示“黄码”或“红码”、体温超过 37.3℃或拒不配合查验的人员，有权拒绝其进入并进行登记上报。请各交易参与者提前到达。因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各交易参与者自行承担。

5、进入代理机构应全程佩戴口罩。进入代理机构时请自觉接受体温检测，进入开标室和评标区时请自觉接受身份核验，体温检测正常（ $< 37.3^{\circ}\text{C}$ ）、身份信息与健康码一致方可进入。对有发热、咳嗽等症状以及不符合疫情防控要求的人员，谢绝进入开标现场参加交易活动，并登记上报。

6、进入代理机构的人员应保持适当的间隔距离，排队等候。注重个人卫生防护，减少触摸扶手、门把等易污染部位和物品，完成交易活动后应尽快离开，在大楼内不聚集、不攀谈、不逗留。

7、评标专家：评标专家入场需提供身份证实名登记并提供近期活动说明，并配合工作人员进行体温测量。配合代理公司做好专家等候管理。专家到达后直接进入评标室/休息区，分散等候，做到不聚集。评标结束后，应立即撤离评标区域，不得擅自逗留、聚集。各评标专家应自主准备口罩等防护用品，全程佩戴参与评标。

第一章 招标公告

扬州仁信工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州市中心血站（以下简称“采购人”）的委托，就扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况

扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”获取招标文件，并于 2022 年 9 月 23 日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：YZRXGK-2022122
- 2、项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目
- 3、项目总预算：120 万元，最高限价：120 万元。报价超过最高限价的投标文件作为无效响应。
- 4、采购需求：扬州市中心血站购置高邮（高邮世贸金街）、宝应（宝应吾悦广场）献血屋及配套设施设备各一套和部分医用设备，要求供应商中标后按要求安放至高邮市区、宝应市区，具体位置由采购人确定。详细要求见招标文件第四章。
- 5、合同履行期限：签订合同后 60 天内完成所有项目内容并通过验收交付使用。
- 6、本项目 不接受联合体投标。
- 7、本项目 不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
 - 1.1 投标函(原件)
 - 1.2 资格声明(原件)
 - 1.3 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)
 - 1.4 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)
 - 1.5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或

社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月（2022年6月-2022年8月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

1.6 投标人近三个月内任意一个月（2022年6月-2022年8月）依法纳税的缴款凭证（复印件加盖投标人公章）

1.7 与上一条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告（复印件加盖投标人公章）

1.8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9 供应商信用承诺书（原件）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于新冠肺炎防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业（中小微企业划型标准网址：http://www.cccp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm；产品生产企业或提供服务/工程企业规模类型自测小程序：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标单位具备医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖投标人公章）；

3.2 投标单位具备第二、第三类医疗器械经营备案凭证（复印件加盖投标人公章）；

3.3 所投产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖投标人公章）。

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述1.5-1.7三项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

4.3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

三、获取招标文件

1、时间：2022年9月2日至2022年9月9日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：“扬州市政府采购网”

3、方式：供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：zc@yzrxgc.cn，联系电话：0514-82101606）**邮件标题为企业全称+项目简称**。代理机构将以邮件回复确认，如未收到回复邮件须电话联系代理机构以确认是否收到。**开标当日交付《供应商参加投标确认函》原件，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。**有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”发布的信息或更正公告。

4、售价：300元，售后不退，请各供应商悉知。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2022年9月23日15点00分（北京时间）

2、地点：扬州仁信工程管理有限公司开标室（扬州市广陵区联谊路与开发东路交叉口东南角，苏高新“名泽园”南门10号商务楼二楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、集中考察或召开答疑会：如潜在投标单位针对本项目有疑问，采购单位及代理公司将汇总疑问，于2022年9月13日在扬州市中心血站召开集中答疑会。

2、本次投标文件制作份数要求：**一式五份**（一份正本，四份副本），每份投标文件须清

楚标明“正本”或“副本”

项目需求及评分标准中要求提供的文件资料（如原件或公证件等属于投标响应文件的组成部分），须在开标当天随投标响应文件一起在投标截止时间前同时递交。

3、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

4、投标文件接收开始时间：2022年9月23日14点30分（北京时间）。

5、凡现场递交响应文件并参加现场开标会的供应商相关人员，需携带《疫情防控期间供应商承诺书》原件出席，详见第六章。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：扬州市中心血站

地址：扬州市玉人路11号

联系方式：殷先生 0514-87959923

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

2、采购代理机构信息

名称：扬州仁信工程管理有限公司

地址：扬州市广陵区联谊路97#苏高新“名泽园”南门10号商务楼

联系方式：0514-82101606

3、项目联系方式

项目联系人：李工

电话：13092036576

扬州仁信工程管理有限公司

2022年9月2日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于 YZRXGK-2022122 号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购由**中标单位**在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)标准七折后一次性支付给招标代理机构服务费；

(1) 招标代理服务费计算公式为：

例如中标价为 110 万元，**招标代理服务费=【100*1.5%+（110-100）*1.1%】*0.7=1.127 万元；**

(2) 招标代理服务费以人民币支付；

(3) 招标代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

(4) 招标代理服务费收款账户信息：

开户银行：中国工商银行扬州市汶河支行

开户名称：扬州仁信工程管理有限公司

开户账号：1108-0209-0910-0123-170

4.3 专家评审费按照扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

4.4 前期咨询费¥15000 元，包含在投标总价中，由中标单位签订合同前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标人应使用人民币报价。

9.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表

中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

本项目**免收投标保证金**。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2 开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
- （2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中

标候选人。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1 无效投标条款

28.1.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2 投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5 未通过符合性检查的；

28.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改

正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5 与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

30.1.1 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

30.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

30.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

30.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按

《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

30.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2 质疑项目的名称、编号；

30.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4 事实依据；

30.4.5 必要的法律依据；

30.4.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：<http://zfcg.yangzhou.gov.cn>

30.5 代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7 代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属

于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.1 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将中标货物及服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第三章 合同条款及格式

政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

甲方（采购人/买方）：扬州市中心血站

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州仁信工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州仁信工程管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

一、服务及产品信息

1.1 货物及服务名称：_____

1.2 型号规格：_____

1.3 数量（单位）：_____

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆（_____元）人民币。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

- | | |
|------------|------------------|
| (1) 招标文件； | (2) 投标产品配置与报价文件； |
| (3) 供货一览表； | (4) 技术参数响应表； |
| (5) 服务承诺； | (6) 中标通知书； |

(7) 甲乙双方补充协议； (8) 乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，验收合格满一年后乙方凭甲方签署的验收合格单申请退还，甲方无息退还。

6.4 履约保证金收取：合同签订前，乙方须向甲方指定账户缴纳中标金额的 10%（¥_____元）作为履约保证金。

账户信息：

户名：扬州市财政局

帐号：1108020929100089868

开户行：工行扬州市汶河支行

社会信用代码：12321000468830536T（请注明：扬州市中心血站）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_____

9.2 交付方式：_____

9.3 交付地点：_____

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：满足合同约定支付条件时，乙方应按合同约定金额开具发票，甲方自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同签订后，甲方收到发票后 15 日内预付合同款的 30%；乙方供货完成，验收合格后 15 日内支付合同款的 70%。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物及服务免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并

由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州仁信工程管理有限公司见证盖章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执壹份。

甲方：扬州市中心血站

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账号：

联系电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

见证方：扬州仁信工程管理有限公司

项目经办人：

日期： 年 月 日

第四章 项目需求

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

说明：加“★”号的内容为采购人基本要求，必须满足；否则可能导致投标文件被评标小组拒绝。

一、采购内容

扬州市中心血站购置高邮（高邮世贸金街）、宝应（宝应吾悦广场）献血屋及配套设施设备各一套和部分医用设备，要求供应商中标后按要求安放至高邮市区、宝应市区，具体位置由采购人确定。

二、项目概况

1、项目总预算：120 万元，最高限价：120 万元。报价超过最高限价的投标文件作为无效响应。

2、合同履行期限：签订合同后 60 天内完成所有项目内容并通过验收交付使用。

3、报价要求：本项目为交钥匙工程，总价应包括但不限于整个献血屋工程、所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、资料费、保修期内维修费用、项目通过验收所包含的各项费用及综合费（包括代理费等）等直至完全交付采购人使用的所有费用。所投产品须符合国家相关技术规范。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

三、设备要求

1、投标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为 100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

4、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

四、服务要求

1、安装和调试：中标单位负责派人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标单位应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

2、技术培训：中标单位应负责对采购人指定人员进行现场培训，直至采购人能完全操作和简单维修。

3、本项目要求投标单位在响应文件中提供搭建后的效果图，包括：献血屋外观、内部总体布局及局部具体细节效果图。

4、中标单位在生产献血屋前，需出具详细的施工方案，包括献血屋的外观、家具式样、内部总体布局、局部具体细节等，所有方案必须经采购人确认后方可定稿。采购人将针对方案提出修改意见，中标单位须按照采购人的意见进行修改，直至采购人对最终方案审核通过后方可开始施工。

5、质量标准：硬件符合国家相关验收标准，可出具环保部门认可的空气质量检测报告，符合环保标准。

6、质保期：

(1) 自竣工验收合格之日起算，献血屋质量保修期至少为三年。保修期届满前，中标单位须对献血屋工程进行全面检查，以达到合同所要求的条件及采购单位认为合格的程度。质量保修期内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由中标单位负责免费维修和更换。在中标单位对质量保修期内出现的质量问题进行维修时，应相应延长维修或更换部分的质量保修期。

(2) 自验收合格之日起算，所有设备及部件提供免费质保：医用冷藏箱、医用血液冷藏箱、医用低温水平式离心机免费质保期至少 3 年；血小板震荡箱、封管热合器、微电脑采液控制器、全自动生化分析仪免费质保期至少 1 年；其他设备及部件免费质保期至少 3 年。质保期内，中标单位须提供所有设施设备的免费维护、维修服务，同时中标单位承诺在质保期结束后，如有发生维护、维修工作，均按相关成本价格收费。

7、中标单位必须能全天即时应答采购人服务需求，采购人在使用过程中如遇有故障，中标单位须在 3 小时内到达现场进行维修，以保障正常采血工作的开展；同时中标单位须定期至献血屋巡回检查，检查频率每月不少于 1 次。

五、其他要求

1、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

2、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，采购人将委托质检机构进行环保、质量检测，验收达不到规范要求、招标文件要求和投标响应文件承诺的，必须更换产品并承担检测费用，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

3、中标单位应为其拟派人员办理各项保险，保险费由中标方承担。在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标方承担。

4、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。

六、参考样式图及技术参数

(一) 高邮献血屋

1、参考样式图

(1) 外观效果图



(2) 前台效果图




(3) 集采室效果图





(4) 平面布置图

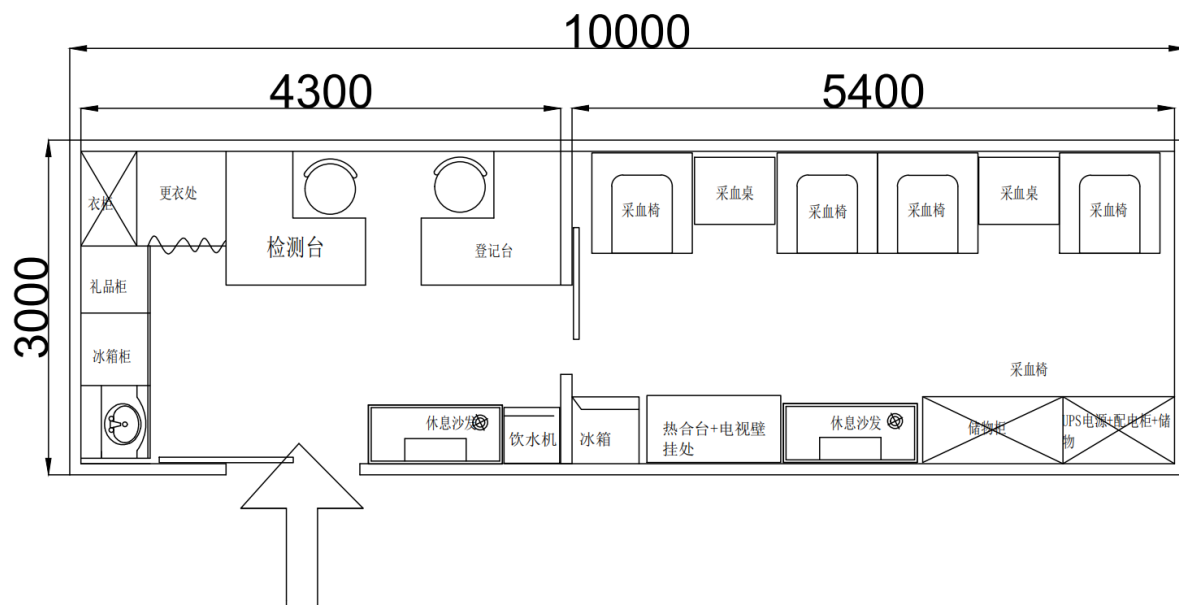

2、技术参数

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量	
▲1	献血屋屋体	屋体尺寸	要求占地面积不少于 30 平方米，主体长*宽*高 ≥ 10 米* ≥ 3 米* ≥ 3.5 米，内部净空间长*宽*高（不小于） ≥ 9.8 米* ≥ 2.8 米* ≥ 2.4 米。	-	
		房屋框架	1、要求钢架采用 14#镀锌槽钢，80*40mm，60*40mm、40*40mm、40*20mm、30*20mm 热镀锌矩形管（国标 GB/T13912-2002）、厚度 3mm 焊接成型，底部 8 根调平支撑。 2、主体为整体钢结构框架，杜绝渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度。 3、外廓尺寸：长 10 米*宽 3 米*高 3.5 米，献血屋底部离地 ≥ 20 cm。	1 套	
		墙体材料及献血屋内部吊顶	1、外墙采用金属材质（亚铝钢板），要求整体阻燃，燃烧性能至少达到 B1 级。表面烤漆，隔热、隔音性能良好。厚度 ≥ 1.7 cm，确保 6 年以上不褪色。 2、内墙采用三聚氰胺板双饰面生态板，内层为实木颗粒，台面硬度大，耐磨，耐热，能抵抗酸、碱、油脂及酒精侵蚀。表面平整、不易变形，颜色鲜艳，易维护清洗。 3、地板基层采用环保竹胶板，厚度 12mm 及木工板，厚度 15mm。 4、地板面层采用 PVC 医用级塑胶地板，耐磨易清洁，整体铺设，厚度 ≥ 2.5 mm。 5、保温层采用阻燃型聚氨酯板材，100*50cm，密度 ≥ 40 。 6、内部吊顶采用环保、防潮、抗菌、耐老化的镁铝合金集成吊顶，包含 LED 灯，静音换气扇。 7、屋顶由钢结构制作造型，自由落水，钢结构支架，铺设上海宝钢彩涂瓦，有岩棉保温隔热层。	1 套	
		门窗及防盗窗	1、铝合金窗要求采用透明双层中空玻璃，保证光线充足，窗户带纱窗；移动窗帘（遮光布阳光面料，天蓝色）。 2、采血区配备大面积落地窗，尺寸按实际情况与采购单位确定，落地窗不可开启，外部不装防盗窗，配窗帘。 3、自动感应门，钢化夹胶玻璃，可手控。 4、防盗设施：小窗户配置不锈钢防盗窗，坚固牢靠美观大方。	1 套	
		防火	防火设施：献血屋内配置 3kg 干粉灭火器。	2 个	
▲2	献血屋内部设施	专用采血桌	1、要求台面下部设有一个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。抽屉上方为推拉板，可放 2 台采血称； 2、尺寸： ≤ 70 cm*60cm*75cm（长*深*高）。	板面材质统一要求为： 三聚氰胺板 双饰面生态	2 张
		热合台	1、要求设有 6 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。同时下设橱柜，柜门须为金属铝框门；		1 张

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			2、尺寸：≤120cm*60cm*780cm（长*深*高）。	
		洗手柜	1、分为台面柜及吊柜，台面柜要求台面放置台上设有洗手盆，下设橱柜；上下柜门统一为金属铝框门；上部为吊柜；水龙头自动控制；有隐藏清洁水箱和污水水箱。 2、台面柜尺寸：≤80cm*50cm*78cm（长*深*高） 3、吊柜尺寸：≤80cm*40cm*60cm（长*深*高） 4、进水、出水装置：净水箱1个，食品级304不锈钢（1.5mm厚），容积≥22L 污水箱1个，食品级304不锈钢（1.5mm厚），容积≥22L 增压泵1个，超静音不锈钢变频恒压全自动增压泵 5、净化装置：自动反冲洗前置过滤器、净水器（无储水装置净水器），过滤等级可直接饮用。	1套
		休息沙发	1、要求凳面下设置橱柜，柜门须为金属铝框门。凳面和靠背铺设软包（皮质）。 2、尺寸：①120cm*55cm*75cm（长*深*高）；②120cm*55cm*75cm（长*深*高）。	2张
		登记台/化验台	1、台面要求为L型，带4个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。下设橱柜，柜门须为金属铝框门。 2、尺寸：≤120cm*120cm*78cm（长*深*高）。	2张
		礼品柜	1、上部柜体要求为铝框玻璃柜门，可放置献血纪念品；柜体中部为2个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道；柜体下部为橱柜，柜门须为金属铝框门。 2、尺寸：≤110cm*50cm*210cm。	1组
		更衣柜	1、按照家居风格设计，分衣柜、储物柜、展示柜等若干柜体。 2、尺寸：≤120*60*210cm	1组
		组合储物柜	1、2个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。 2、尺寸：≤140*60*210cm（长*深*高）	1组
		采血椅	要求电动功能型献血椅。安全舒适，如献血者出现献血反应，可直接躺下，缓解献血反应，躺平角度≥170度。 1、椅面尺寸：坐深≥53cm，坐宽≥42cm；椅面高度：≤50cm；扶手尺寸：宽≤29cm，长≤52cm。 2、椅面前后倾角度：放平后椅面与靠背≥170度。 3、表面材质：推荐黄牛头层皮，天然纹理；框架：环保无毒；坐垫：35密度高回弹聚氨酯海绵，弹性持久；靠背和扶	4张

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			手内部填充三维中空聚酯短纤。 4、电机标准行程：333mm；电机最大负载：800N；电机输入电压：29V；电机最大速度：36rpm；输入功率：75W；电源电压/频率：220V/50HZ；电机功率：50W。 5、载重：≥150kg；自重：≤55kg。	
		工作转椅	转椅为皮面质地，φ320，带汽杆高度可调、皮面。	无靠背 4把 有靠背 4把
▲3	电路系统、照明系统		总体要求：满足采血需要，电源 220V，总功率 20Kw 以上，室内照明的亮度适合采血作业，配备应急照明设施及应急电源、不间断电源供电时间不少于 2 小时（除空调）。	-
		10A 5 孔电源插座	按用电负荷装配电源插座，所有接线均要求按三线制接线。	按需配备
		线路总成	献血屋布线采用三线制。总线、空调 10 平方，支线 4 平方和 2.5 平方。UPS 电源，保证线缆均有阻燃蛇形绝缘管或 PVC 线槽保护、布线间无接头。	1 套
		外接电源线	配电箱总输入线，10 方 3 芯防水线 50 米，配 63A 工业用电源插座插头。	
		不间断电源控制器	10kva，保障除空调、照明外其他设备的应急供电，延时至少 2 小时。	
		照明灯	吊顶集成 LED 灯。功率：36W/个。	8 个
		网络布线	户外彩色显示屏通过电脑网线连接；LED 字幕通过 USB 接口连接。	1 套
▲4	广告宣传	LED 电子显示屏	1、要求 P5 户外彩色 LED 室外显示屏：要求微电脑时控开关控制，配备编程软件，台湾芯片。可通过网线传输数据，电脑编辑内容，传输结束后无需连接电脑便可独立播放，配有室外音响（如有控制软件，安装结束后归血站所有）；采用不锈钢围边。 2、尺寸：≤2.2m*1.8m。	1 块
			1、P10 户外红色 LED 字幕：要求有 USB 接口连接，可电脑编辑内容，传输结束后无需连接电脑便可独立播放。采用不锈钢围边（如有控制软件，安装结束后归血站所有）。	1 块

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			2、尺寸为：≤3m*0.4。	
		屋顶广告字	1、字体内容：爱心献血屋；广告字要求 LED 发光，采用不锈钢围边，红色亚克力面板；通过时控开关控制。 2、单个字尺寸为：≤100cm*100cm	5 个
		宣传画	1、可更换式框架，含宣传画制作。 2、尺寸为：≤2.2m*1.8m。	2-4 块
▲5	其他设备	空调	2P 吸顶机，适用面积 22-34 m ² ，能效比：4.5，能效等级二级以上。	2 台
		电视	屏幕尺寸：50 英寸，带硬盘播放功能（USB 接口）、配硬盘播放器。	1 台
		微波炉	额定频率：50Hz 变频/定频：定频 额定电压：220V 产品尺寸：长≤457mm；宽≤395mm；高≤271mm 容量：≥20L 产品净重：≤11KG 微波功率：700W	1 台
		饮水机	额定频率：50Hz 产品尺寸：长≤303mm；宽≤296mm；高≤365mm 储藏箱容量：0.1L 加热功率：300W 产品净重：≤1.7kg 额定电压：220V 制热量：≤3L/h	1 台
		安保监控系统	要求内配 4 只高清半球式摄像机，外部配枪式高清摄像机 2 只，具有红外线夜视功能，存储硬盘可存 6 个月记录。手机可以连接。	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
		紫外线消毒灯	功率：40W，单支长度：120cm；配置定时功能开关及控制器。	4 只
		打印机	产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达 2400×600dpi） 黑白打印速度：25ppm 内存：标配：64MB，最大：64MB 双面打印：自动 网络功能：支持有线网络打印 耗材类型：鼓粉一体 介质尺寸：A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，16K，信封，自定义尺寸 产品尺寸：长≤379 宽≤293 高≤243mm 系统平台：Windows 8.1/8/7/XP/Vista/Server2012/Server 2012 R2(64bit)/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Mac OS X	1 台
		体重秤	规格：最大称量:200 kg； 技术指标：外包装尺寸：≤100 cm×32 cm×26 cm； 净重：13 kg，毛重:15 kg； 承重板面积：≤37.5 cm×27.5 cm； 外形尺寸：≤53.5cm×27.5 cm×94 cm； 身長器测量范围(分度值为 0.5 cm)：70 cm-190 cm； 最大称量：200 kg； 最小分度值：100 g。	1 台
		等离子空气消毒机（吸顶）	1、产品质量：重量≤3kg，便于壁挂安装； 2、输出功率：≤20W； 3、消毒方式：电化学主动式消毒，非过滤式无耗材、免维护；	2 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
		式)	4、消毒范围：对密闭环境内空气和物体表面实施全方位无死角消毒； 5、消毒因子：低温等离子体； 6、产品为壁挂式，可进行多方位快速消毒； 7、产品工作中不产生如紫外线、过量的臭氧、氧族物质等有害因素，符合人机共存的实时动态消毒要求； 8、产品符合国家卫生健康委员会 WS/T648-2019（2019）4 号中 6.4.2 条例规定：等离子体空气消毒机内部不得装有高效过滤器和紫外线杀菌灯； 9、产品空气消毒效果：开机消毒作用 20min，对体积约 20m ³ 无人密闭房间空气自然菌的消亡率 >90%； 10、产品空气消毒效果：模拟现场消毒试验白色葡萄球菌杀灭率 ≥99.90%，现场消毒试验空气中空气自然菌消灭率 ≥90.00%。	
		风幕机	1.5KW，超强静音，安装于献血屋入口处（1.2 米宽），利于隔热。	1 套
		笔记本电脑	处理器：12 代英特尔酷睿 i5，内存 16G，固态硬盘 1T，屏幕尺寸：14.0-14.9 英寸，系统：Windows 10	1 台
		新风系统	根据室内面积安装一套新风系统，以保证室内空气流通及清新。	1 套
▲6	微电脑采液控制器		1、独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了； 2、采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血； 3、通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷； 4、大容量托盘，更适合进行多连袋、大量程的采液； 5、托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁； 6、具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性； 7、计量单位 ml、g 可一键转换； 8、采液量：50~1000ml； 9、液体比重：1.05g/ml； 10、分度值：2ml 或 2g；	4 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量									
			11、摇摆角度： $13^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ； 12、摇摆频率： 30 ± 2 次 / 分； 13、电源：AC220V 50Hz； 14、输入功率： ≤ 40 W； 15、工作环境： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 室内； 16、报警：自动声光报警，当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示； 17、采液控制量(ml)：100、200、300、400； 18、外形尺寸(mm)： $\leq 170 \times 275 \times 150$ (宽 \times 深 \times 高)； 19、重 量： ≤ 2.0 kg； 20、计时报警： <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>200ml</td> <td>5 分钟后声光报警</td> <td>7 分钟后声光急促报警</td> </tr> <tr> <td>300ml</td> <td>7 分钟后声光报警</td> <td>10 分钟后声光急促报警</td> </tr> <tr> <td>400ml</td> <td>10 分钟后声光报警</td> <td>13 分钟后声光急促报警</td> </tr> </table>	200ml	5 分钟后声光报警	7 分钟后声光急促报警	300ml	7 分钟后声光报警	10 分钟后声光急促报警	400ml	10 分钟后声光报警	13 分钟后声光急促报警	
200ml	5 分钟后声光报警	7 分钟后声光急促报警											
300ml	7 分钟后声光报警	10 分钟后声光急促报警											
400ml	10 分钟后声光报警	13 分钟后声光急促报警											
▲7	医用低温水平式离心机		适用于采血使用的真空采血管、核酸离心管等试管的离心，尤其适合核酸离心检测，不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。吸盘机脚能牢牢抓住放置表面，即使在行车时也无需担心离心机移动，全封闭旋转式压缩机。 采用双层结构，外型尺寸 $\leq 400 \times 500 \times 350$ (mm)，极大的节约有效空间。 5 英寸 HD 触摸屏控制，操控方便、直观，设定参数及运行参数同屏显示。 配有多种适配器，可分离真空采血管 2~5ml、核酸离心管 8~10ml 及其他 10ml 试管，一机多用。 吸盘机脚，能使离心机固定于放置面，安全可靠。 产品符合 IS09001 及 IS013485 质量管理体系认证要求。 具有超速、超温、门锁等多种保护功能，使用仪器安全可靠。 最高转速 ≥ 5000 r/min 最大相对离心力 $\geq 3354 \times g$ 转速精度： ± 30 r/min 最大容量： 8×10 ml 定时范围：1min~99min	2 套									

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			温度设置范围：-20~40℃ 温度控制精度：±2.0℃ 整机噪声：≤60dB(A) 电源：AC220V±22V 50/60Hz 整机功率：450W 外形尺寸：330×450×330mm(L×W×H) 重量：≤45kg 配备转子：8*10ml 水平转子（最高转速：5000r/min，最大相对离心力：3354xg）	
▲8		封管热合器	1、机体超薄设计，机器宽度不大于 6.5cm，小巧轻便，节省台面空间。 2、一机三用：具有三种使用模式，可单台、多台联排、外接热合手柄使用，匹配不同的使用场景。 3、具有 LED 环行工作状态指示灯，明确提示热合进程：一个绿色指示灯（待机状态）、五个绿色指示灯（热合状态）、五个琥珀色指示灯（调整状态）。 4、管路规格：PVC 管路，最大管径达 6.0 毫米。 5、热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，也可人工调节。 6、方便携带：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动。 7、宽电压供电，输入电压/频率：100-250VAC，50/60Hz。 8、最大射频输出：150W /40.68MHz，对不同血袋管材均能进行良好的热合。 9、热合头间距设置：距离 65-100mm 可调，并可根据具体需求调整固定。 10、三重滤波屏蔽辐射：设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全，出具国家权威认证机构出具的检测报告。 11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片，能有效避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，既保证操作人员安全又使操作者能够直观看到整个热合过程。 12、标配可拆卸的热合卡槽，专为并联热合设计，可防止并联热合时管路过长，管路中间不受力引起管路偏移、不在热合点上，导致热合失败或不完全热合的发生，避免热合不完整、热合漏血等风险的发生。 13、电火花警报：热合中产生电火花，会响起一声报警并伴随指示灯闪烁。机器温度报警：内部温度超过 60℃会发出	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			<p>报警。</p> <p>14、空热合报警：如果热合头中的触发杆在没有血袋管的情况下被压下，会有声音报警和指示灯闪烁。热合时间超过预设的安全时间,会有 1.5 秒的声音报警和指示灯闪烁报警。</p> <p>15、具有移动热合的接口，可连接热合手柄，电缆线≥ 1.8 米，方便移动热合。</p> <p>16、具备热合功率调节功能，针对不同的血袋选择不同的功率，调节档位：三档。</p> <p>17、散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，保证机器可连续工作 8 小时以上。</p> <p>18、主机尺寸(WxHxD)：$\leq 65 \times 167 \times 365$ mm。</p> <p>19、热合手柄尺寸(WxHxD)：$\leq 28 \times 44 \times 204$ mm。</p> <p>20、主机重量：≤ 3.6 Kg。</p> <p>21、手柄重量：≤ 0.22 Kg。</p> <p>22、热合时间≤ 1 秒。</p> <p>23、消耗功率：工作：≤ 250W；待机：≤ 10W。</p> <p>24、辐射防护安全性：确保高频 40.68MHz 工作下，辐射强度不超过 68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。</p> <p>25、仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞。</p>	
▲9		电子血压计	<p>检测方式：臂式</p> <p>工作模式：全自动</p> <p>加压方式：智能加压</p> <p>测量精度：< 5 毫米汞柱</p> <p>测量范围：压力：$0 \sim 299$mmHg ($0 \sim 39.9$kPa)</p> <p>记忆组数：≥ 14 组</p> <p>脉搏数：$40 \sim 180$ 次/分</p> <p>电源类型：4 节 5 号电池或电源适配器</p> <p>外包装尺寸（mm）宽$\leq 103 \times$高$\leq 80 \times$厚≤ 129m</p>	1 台
▲10		全自动生化分析仪	1、操作系统：全中文图形化界面，7 英寸彩色高清触摸操作，方便工作人员操作；	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			2、分析项目：ALT、HGB，乳糜血识别，样品溶血四项联检，同时定量出四项结果； 3、通道：4 通道，可同时检测 4 个样本（每个样本检测 4 项）； 4、检测速度：循环检测，可任意添加样本； 5、样本量：全血 30ul； 6、波长：340nm—540nm； 7、分析方法：速率法，比色法、比浊法； 8、检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆； 9、加样系统：高精度吸样探针，机械臂全自动加样，无需手工加样； 10、液位感应：精准数字液位探测，随时跟踪报警功能； 11、恒温系统：反应区温控精度 37℃ ± 0.1℃，实时温度显示，需要的时间：3 分钟； 12、转氨酶试剂保护：标配制冷单元，转氨酶试剂在使用中始终在 2-8° C； 13、预装单人份试剂，无需现场配备无需预热即可使用； 14、重量：≤7kg，方便携带； 15、占用台面空间(长×宽)：≤34cm×21cm。节省空间、方便台面放置； 16、工作环境温度：0-45℃； 17、抗颠簸设计、仪器能很好的适应在流动采血车上正常使用； 18、标配防滑提手，方便携带移动； 19、电源：AC 220v/50Hz。	
▲11	医用血液冷藏箱		1、门体：采用立式单门设计，大视角双层电加热玻璃发泡门体，自关门功能。 2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在 4±1℃ 范围内，控温精度 0.1° C。 3、显示：LED 数码管显示，内温度恒定控制在 2-6℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率 0.1℃。 4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。	1 台


序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			<p>6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。</p> <p>7、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。</p> <p>8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>9、配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。</p> <p>10、压缩机：进口压缩机，节能低噪，使用寿命长。</p> <p>11、冷凝风机：进口冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。</p> <p>12、不锈钢内胆设计，防腐抑菌。</p> <p>13、门锁功能，防止随意开门。</p> <p>14、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。</p> <p>15、箱内 5 个高精度传感器，带防高温和防低温机械控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。</p> <p>16、单独电源开关设计，方便人员安全操作。</p> <p>17、箱内设置 LED 照明灯，外部独立灯开关。</p> <p>18、4 个搁架，4 个血筐，2 个透明亚克力内门，可减小开门取血的冷量散失。</p> <p>19、具有医疗器械注册证。</p> <p>20、外部尺寸(mm)（宽*深*高）：≤570*570*1550。</p> <p>21、有效容积≥150L。</p>	
▲12	医用冷藏箱		<p>1、有效容积：外部尺寸≤495mm*580mm*660mm；内部尺寸≥415mm*385mm*505mm；有效容积≥68L，立式，可桌上放置；</p> <p>2、整体结构：采用 LBA 无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用 PS 吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；</p> <p>3、温度控制：箱内温度稳定在 2℃~8℃，电脑板控温，LED 数字显示箱内温度，显示精度控制精度均为 0.1℃，显示板密码保护功能，保护参数不能随意更改，保证温度的一致性；</p> <p>4、核心组件：压缩机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，采用双直流风机，通过 12V 安全电压供电，使用更安全，性能更稳定；</p>	1 台

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			<p>5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；</p> <p>6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷循环，保证箱内体温度均匀性$\leq 2^{\circ}\text{C}$，波动值$\leq 2^{\circ}\text{C}$；</p> <p>7、门体结构：采用真空双层钢化玻璃门体，采用铝合金门框，美观耐用，门体安装一体式门把手，开启更方便；门体采用电极式加热防凝露设计，32°C环温 85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见，门体具有自关门设计，防止开门后忘记关门；</p> <p>8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；</p> <p>9、合理布局：产品内部配有 2 层蘸塑搁架及 1 个储物筐，搁架高度可调整，储物空间按需调节；</p> <p>10、温度监控：产品配有一个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测；</p> <p>11、柜内照明：内设 12VLED 照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；</p> <p>12、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；</p> <p>13、停电报警：配备直流 12V 可充电锂电池，满容量可保障停电报警 8 小时；</p> <p>14、安全保障：门体上部带锁，储物更加安全；</p> <p>15、宽电压带：产品配备宽电压带，适合 198~242V 电压下使用；</p> <p>16、固定移动：产品配备 4 个底脚，便于移动且固定方便。</p>	


(二) 宝应献血屋

1、参考样式图

(1) 外观效果图

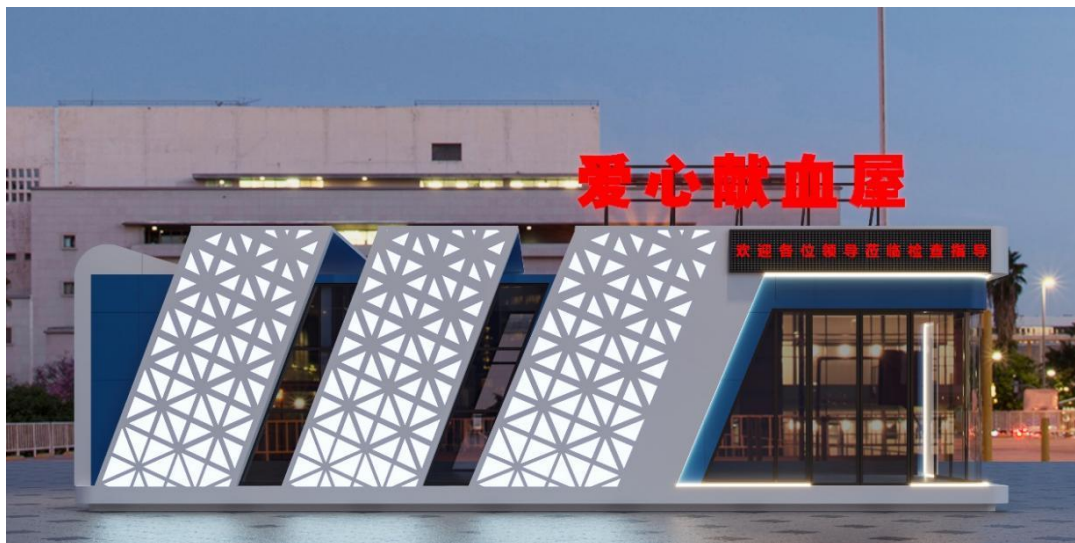

(2) 前台效果图

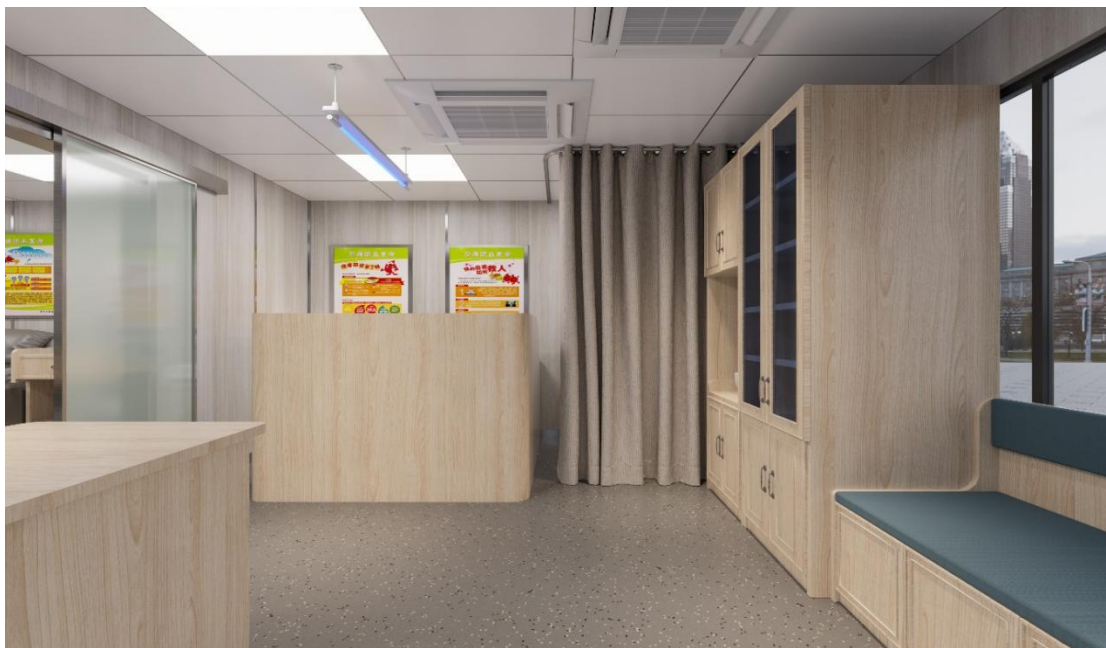

(3) 集采室效果图




(4) 单采室效果图





(5) 平面布置图

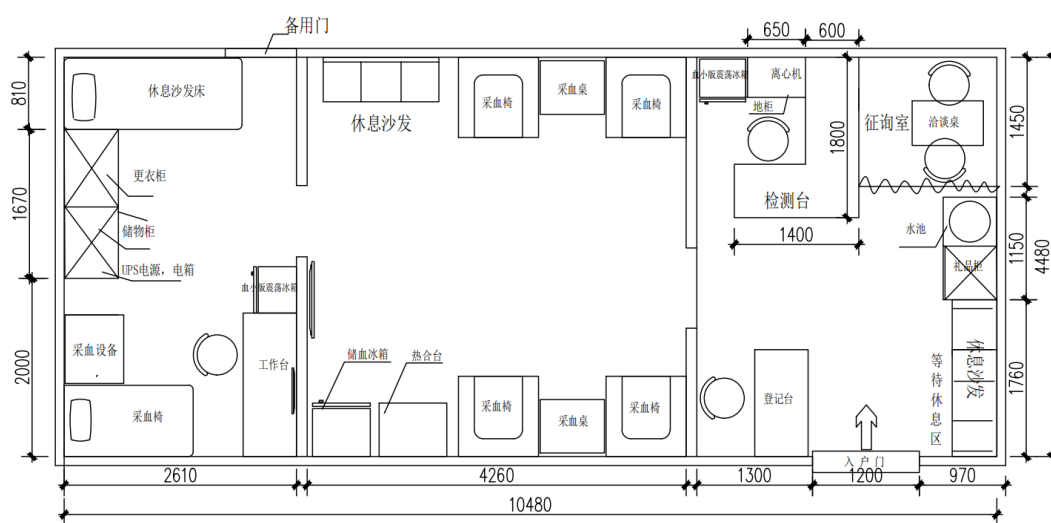

2、技术参数

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量	
▲1	献血屋屋体	屋体尺寸	要求占地面积不少于 50 平方米，主体长*宽*高 ≥ 10.5 米* ≥ 4.8 米* ≥ 3.5 米，内部净空间长*宽*高（不小于） ≥ 10 米* ≥ 4.5 米* ≥ 2.4 米。	-	
		房屋框架	1、要求钢架采用 14#镀锌槽钢，40*80mm、40*60mm、40*40mm、40*20mm、30*20mm 热镀锌矩形管（国标 GB/T13912-2002）、厚度 3mm 焊接成型，底部 8 个调平支撑 2、主体为整体钢结构框架，杜绝渗水、漏水。所有管材焊接前要求做去锈、防锈漆防腐处理，整体焊接完成后须再喷涂一遍防锈漆，要充分满足整体的强度和刚度； 3、外廓尺寸：长 10 米*宽 4.5 米*高 3.5 米，献血屋底部离地 ≥ 20 cm。	1 套	
		墙体材料及献血屋内部吊顶	1、外墙采用玻璃钢材质加阻燃板，要求整体阻燃，燃烧性能至少达到 B1 级。表面烤漆，隔热、隔音性能良好。厚度 ≥ 10 mm，确保 6 年以上不褪色。 2、内墙采用 E1 级双面细木工板。 3、地板基层采用环保竹胶板，厚度 12mm。 4、地板面层采用 PVC 医用级塑胶地板，耐磨易清洁，整体铺设，厚度 ≥ 2.5 mm。 5、保温层采用阻燃型聚氨酯板材，100*50cm，密度 ≥ 40 。 6、内部吊顶采用环保、防潮、抗菌、耐老化的镁铝合金集成吊顶，包含 LED 灯。 7、屋顶由钢结构制作造型，自由落水，钢结构支架，铺设上海宝钢彩涂瓦，有岩棉保温隔热层。	1 套	
		门窗及防盗窗	1、铝合金窗要求采用透明双层中空玻璃，保证光线充足，窗户带纱窗；移动窗帘（遮光布阳光面料，天蓝色）。 2、采血区和单采室配备落地窗，宽约 0.8 米，高约 2.2 米，落地窗不可开启，外部不装防盗窗，配窗帘。 3、自动感应门，钢化夹胶玻璃，可手控。 4、防盗设施：窗户配置不锈钢防盗窗，坚固牢靠美观大方。	1 套	
		防火	防火设施：献血屋内配置 3kg 干粉灭火器。	6 个	
▲2	献血屋内部设施	专用采血桌	1、要求台面下部设有一个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。抽屉上方为推拉板，可放 2 台采血称； 2、尺寸： ≤ 700 cm* 600 cm* 75 cm（长*深*高）。	板面材质统一要求为： 三聚氰胺板双饰面生态板， 内层为实木颗粒	2 张
		热合台	1、要求设有 6 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。同时下设橱柜，柜门须为金属铝框门； 2、尺寸： ≤ 760 cm* 60 cm* 760 cm（长*深*高）。		1 张

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
		洗手柜	1、分为台面柜及吊柜，台面柜要求台面放置台上设有洗手盆，下设橱柜；上下柜门统一为金属铝框门；上部为吊柜。 2、台面柜尺寸： $\leq 80\text{cm} \times 50\text{cm} \times 75\text{cm}$ （长*深*高） 3、吊柜尺寸： $\leq 80\text{cm} \times 40\text{cm} \times 60\text{cm}$ （长*深*高） 4、进水、出水装置：净水箱 1 个，食品级 304 不锈钢（1.5mm 厚），容积 $\geq 22\text{L}$ 污水箱 1 个，食品级 304 不锈钢（1.5mm 厚），容积 $\geq 22\text{L}$ 增压泵 1 个，超静音不锈钢变频恒压全自动增压泵 5、净化装置：自动反冲洗前置过滤器、净水器（无储水装置净水器），过滤等级可直接饮用。	1 套
		休息沙发	1、要求凳面下设置橱柜，柜门须为金属铝框门。凳面和靠背铺设软包。 2、尺寸：① $\leq 175\text{cm} \times 60\text{cm} \times 75\text{cm}$ （长*深*高）2 个；② $\leq 120\text{cm} \times 50\text{cm} \times 75\text{cm}$ （长*深*高）1 个。	3 张
		初筛/化验台	1、台面要求为 L 型，双层台面，带 4 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。下设橱柜，柜门须为金属铝框门。 2、尺寸： $\leq 1400\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 600\text{mm}$ （长*深*高*宽）	2 张
		化验台地柜	柜门须为金属铝框门。 多层实木板材（ $\leq 650\text{mm} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm}$ ）（长*宽*高）	1 张
		洽谈桌	多层实木板材（ $\leq 800\text{mm} \times 450\text{mm} \times 700\text{mm}$ ）（长*宽*高）	1 张
		登记台（双层）	双层台面，带 3 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。下设橱柜，柜门须为金属铝框门。 多层实木板材（ $\leq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1100\text{mm}$ ）（长*宽*高）	1 张
		单采室工作台	带 3 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。下设橱柜，柜门须为金属铝框门。 多层实木板材，台面选用大理石板（ $\leq 1600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$ ）（长*宽*高）	1 张

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量	
		纪念品展示品柜	1、上部柜体要求为铝框玻璃柜门，可放置献血纪念品；柜体中部为 2 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道；柜体下部为橱柜，柜门须为金属铝框门。 2、尺寸：≤1200mm*600mm*2200mm	1 组	
		更衣柜	1、按照家居风格设计，分衣柜、储物柜、展示柜等若干柜体。 2、尺寸：≤100*50*220cm		1 组
		组合储物柜	1、2 个抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。 2、尺寸：≤50*60*220cm（长*深*高）		1 张
		采血椅	要求电动功能型献血椅。安全舒适，如献血者出现献血反应，可直接躺下，缓解献血反应，躺平角度≥170 度。 1、椅面尺寸：坐深≥53cm，坐宽≥42cm；椅面高度：≤50cm；扶手尺寸：宽≤29cm，长≤52cm。 2、椅面前后倾角度：放平后椅面与靠背≥170 度。 3、表面材质：推荐黄牛头层皮，天然纹理；框架：环保无毒；坐垫：35 密度高回弹聚氨酯海绵，弹性持久；靠背和扶手内部填充三维中空聚酯短纤。 4、电机标准行程：333mm；电机最大负载：800N；电机输入电压：29V；电机最大速度：36rpm；输入功率：75W；电源电压/频率：220V/50HZ；电机功率：50W。 5、载重：≥150kg；自重：≤55kg。	5 张	
		工作转椅	转椅为皮面质地，φ320，带汽杆高度可调、皮面。	无靠背 有靠背	6 把 4 把
▲3	电路系统、照明系统	总体要求：满足采血需要，电源 220V，总功率 20Kw 以上，室内照明的亮度适合采血作业，配备应急照明设施、不间断电源供应。		-	
		10A 5 孔电源插座	按用电负荷装配电源插座，所有接线均要求按三线制接线。	按需配备	
		线路总成	献血屋布线采用三线制。总线、空调 6 平方，支线 2.5 平方。UPS 电源，保证线缆均有阻燃蛇形绝缘管或 PVC 线槽保护、布线间无接头。	1 套	
		外接电	配电箱总输入线，16 方 3 芯防水线 50 米，配 100A 工业用电源插座插头。		

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
		源线		
		不间断电源控制器	3kva, 保障除空调、照明外其他设备的应急供电, 延时至少 1 小时。	
		照明灯	吊顶集成 LED 灯。功率: 18W/个	14 个
		网络布线	户外彩色显示屏通过电脑网线连接; LED 字幕通过 USB 接口连接。	1 套
▲4	广告宣传	LED 电子显示屏	<p>1、要求 P5 户外彩色 LED 室外显示屏: 要求微电脑时控开关控制, 配备编程软件, 台湾芯片。可通过网线传输数据, 电脑编辑内容, 传输结束后无需连接电脑便可独立播放, 配有室外音响 (如有控制软件, 安装结束后归血站所有); 采用不锈钢围边。</p> <p>2、尺寸: $\leq 2.2\text{m} \times 1.8\text{m}$。</p> <p>3、像素结构: SMD2525 三合一 LED</p> <p>像素间距: 5mm; 40000 点/m^2</p> <p>模组分辨率: $64 \times 32 = 2048$</p> <p>模组尺寸: $320 \times 160\text{mm}$</p> <p>模组重量: 0.42kg</p> <p>模组最大功耗: 40W</p> <p>白平衡: $\geq 4000\text{nits}$</p> <p>色温: 2000-9300k</p> <p>视角: 水平 140° / 垂直 120°</p>	1 块

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			对比度：5000：1 驱动方式：恒流驱动，32 扫 灰度级别：16384 刷新率：≥1920Hz 颜色处理位数：14bit 寿命典型值：100000H 工作温/温度范围：-10-40℃/10%-80RH(无结露) 存储温/温度范围：-20-60℃/10%-85RH(无结露)	
			1、P10 户外红色 LED 字幕：要求有 USB 接口连接，可电脑编辑内容，传输结束后无需连接电脑便可独立播放（如有控制软件，安装结束后归血站所有）。采用不锈钢围边。 2、尺寸为：≤3m*0.4	1 块
		屋顶广告字	1、字体内容：爱心献血屋；广告字要求 LED 发光，采用不锈钢围边，红色亚克力面板；通过时控开关控制； 2、单个字尺寸为：≤100cm*100cm。	5 个
		宣传画	1、可更换式框架，含宣传画制作 2、尺寸为：≤2.2m*1.8m	2-4 块
▲5	设备其他	空调	2P 吸顶机，适用面积 22-34 m ² ，能效比：4.5，能效等级二级以上。	3 台
		电视	屏幕尺寸：50 英寸 1 台，32 寸液晶电视 1 台，均可通过 USB 接口独立播放，配硬盘播放器。	2 台
		微波炉	额定频率：50Hz 变频/定频：定频 额定电压：220V	1 台

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			产品尺寸：长≤457mm；宽≤395mm；高≤271mm 容量：≥20L 产品净重：≤11KG 微波功率：700W	
		饮水机	额定频率：50Hz 产品尺寸：长≤303mm；宽≤296mm；高≤365mm 储藏箱容量：0.1L 加热功率：300W 产品净重：≤1.7kg 额定电压：220V 制热量：≤3L/h	1 台
		安保监控系统	要求内配 6 只高清半球式摄像机，外部配枪式高清摄像机 2 只，具有红外线夜视功能，存储硬盘可存 6 个月记录。	1 套
		紫外线消毒灯	功率：40W，单支长度：120cm；配置定时功能开关及控制器。	3 只
		打印机	产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达 2400×600dpi） 黑白打印速度：25ppm 内存：标配：64MB，最大：64MB 双面打印：自动 网络功能：支持有线网络打印 耗材类型：鼓粉一体 介质尺寸：A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，16K，信封，自定义尺寸 产品尺寸：长≤379 宽≤293 高≤243mm	1 台

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			系统平台: Windows 8.1/8/7/XP/Vista/Server2012/Server 2012 R2(64bit)/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2Mac OS X	
		体重秤	规格:最大秤量:200 kg; 技术指标:外包装尺寸: ≤100 cm×32 cm×26 cm; 净重: ≤13 kg, 毛重: ≤15 kg; 承重板面积: ≤37.5 cm×27.5 cm; 外形尺寸: ≤53.5cm×27.5 cm×94 cm; 身長器测量范围(分度值为 0.5 cm):70 cm-190 cm; 最大秤量:200 kg; 最小分度值:100 g	1 台
		等离子空气消毒机(吸顶式)	1、产品质量: 重量≤3kg, 便于壁挂安装; 2、输出功率: ≤20W; 3、消毒方式: 电化学主动式消毒, 非过滤式无耗材、免维护; 4、消毒范围: 对密闭环境内空气和物体表面实施全方位无死角消毒; 5、消毒因子: 低温等离子体; 6、产品为壁挂式, 可进行多方位快速消毒; 7、产品工作中不产生如紫外线、过量的臭氧、氧族物质等有害因素, 符合人机共存的实时动态消毒要求; 8、产品符合国家卫生健康委员会 WS/T648-2019 (2019) 4 号中 6.4.2 条例规定: 等离子体空气消毒机内部不得装有高效过滤器和紫外线杀菌灯; 9、产品空气消毒效果: 开机消毒作用 20min, 对体积约 20m ³ 无人密闭房间空气自然菌的消亡率>90%; 10、产品空气消毒效果: 模拟现场消毒试验白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%, 现场消毒试验空气中空气自然菌消灭率≥90.00%。	3 套
		风幕机	1.5KW, 超强静音, 安装于献血屋入口处 (1.2 米宽), 利于隔热。	1 套
		新风系	根据室内面积安装一套新风系统, 以保证室内空气流通及清新	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
		统		
		笔记本电脑	处理器：12代英特尔酷睿 i5，内存 16G，固态硬盘 1T，屏幕尺寸：14.0-14.9 英寸，系统：Windows 10	1 台
▲6	微电脑采液控制 器		<p>1、独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了；</p> <p>2、采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血；</p> <p>3、通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷；</p> <p>4、大容量托盘，更适合进行多连袋、大量程的采液；</p> <p>5、托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁；</p> <p>6、具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性；</p> <p>7、计量单位 ml、g 可一键转换；</p> <p>8、采液量：50~1000ml；</p> <p>9、液体比重：1.05g/ml；</p> <p>10、分度值：2ml 或 2g；</p> <p>11、摇摆角度：13° ±2° ；</p> <p>12、摇摆频率：30±2 次 / 分；</p> <p>13、电源：AC220V 50Hz；</p> <p>14、输入功率：≤40W；</p> <p>15、工作环境：0℃~40℃室内；</p> <p>16、报警：自动声光报警，当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示；</p> <p>17、采液控制量(ml)：100、200、300、400；</p> <p>18、外形尺寸(mm)：≤170×275×150 （宽×深×高）；</p> <p>19、重 量： 2.0kg；</p> <p>20、计时报警： 200ml 5 分钟后声光报警 7 分钟后声光急促报警 300ml 7 分钟后声光报警 10 分钟后声光急促报警</p>	4 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			400ml 10 分钟后声光报警 13 分钟后声光急促报警	
▲7	医用低温水平式离心机		<p>适用于采血使用的真空采血管、核酸离心管等试管的离心，尤其适合核酸离心检测，不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。吸盘机脚能牢牢抓住放置表面，即使在行车时也无需担心离心机移动，全封闭旋转式压缩机。</p> <p>采用双层结构，外型尺寸$\leq 400 \times 500 \times 350$(mm)，极大的节约有效空间。</p> <p>5 英寸 HD 触摸屏控制，操控方便、直观，设定参数及运行参数同屏显示。</p> <p>配有多种适配器，可分离真空采血管 2~5ml、核酸离心管 8~10ml 及其他 10ml 试管，一机多用。</p> <p>吸盘机脚，能使离心机固定于放置面，安全可靠。</p> <p>产品符合 ISO9001 及 ISO13485 质量管理体系认证要求。</p> <p>具有超速、超温、门锁等多种保护功能，使用仪器安全可靠。</p> <p>最高转速≥ 5000r/min 最大相对离心力$\geq 3354 \times g$ 转速精度：± 30r/min 最大容量：8×10ml 定时范围：1min~99min 温度设置范围：$-20 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 温度控制精度：$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 整机噪声：≤ 60dB(A) 电源：$AC220V \pm 22V$ 50/60Hz 整机功率：450W 外形尺寸：$330 \times 450 \times 330$mm(L$\timesW\times$H) 重量：$\leq 45$kg 配备转子：$8 \times 10$ml 水平转子（最高转速：$5000$r/min，最大相对离心力：$3354 \times g$）</p>	1 套
▲8	封管热合器		<p>1、机体超薄设计，机器宽度不大于 6.5cm，小巧轻便，节省台面空间。</p> <p>2、一机三用：具有三种使用模式，可单台、多台联排、外接热合手柄使用，匹配不同的使用场景。</p> <p>3、具有 LED 环行工作状态指示灯，明确提示热合进程：一个绿色指示灯（待机状态）、五个绿色指示灯（热合状态）、</p>	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			<p>五个琥珀色指示灯（调整状态）。</p> <p>4、管路规格：PVC 管路，最大管径达 6.0 毫米。</p> <p>5、热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，也可人工调节。</p> <p>6、方便携带：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动。</p> <p>7、宽电压供电，输入电压/频率：100-250VAC，50/60Hz。</p> <p>8、最大射频输出：150W /40.68MHz，对不同血袋管材均能进行良好的热合。</p> <p>9、热合头间距设置：距离 65-100mm 可调，并可根据具体需求调整固定。</p> <p>10、三重滤波屏蔽辐射：设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全，出具国家权威认证机构出具的检测报告。</p> <p>11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片，能有效避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，既保证操作人员安全又使操作者能够直观看到整个热合过程。</p> <p>12、标配可拆卸的热合卡槽，专为并联热合设计，可防止并联热合时管路过长，管路中间不受力引起管路偏移、不在热合点上，导致热合失败或不完全热合的发生，避免热合不完整、热合漏血等风险的发生。</p> <p>13、电火花警报：热合中产生电火花，会响起一声报警并伴随指示灯闪烁。机器温度报警：内部温度超过 60℃会发出报警。</p> <p>14、空热合报警：如果热合头中的触发杆在没有血袋管的情况下被压下，会有声音报警和指示灯闪烁。热合时间超过预设的安全时间，会有 1.5 秒的声音报警和指示灯闪烁报警。</p> <p>15、具有移动热合的接口，可连接热合手柄，电缆线≥1.8 米，方便移动热合。</p> <p>16、具备热合功率调节功能，针对不同的血袋选择不同的功率，调节档位：三档。</p> <p>17、散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，保证机器可连续工作 8 小时以上。</p> <p>18、主机尺寸(WxHxD)：≤65x167x365 mm。</p> <p>19、热合手柄尺寸(WxHxD)：≤28x44x204 mm。</p> <p>20、主机重量：≤3.6 Kg。</p> <p>21、手柄重量：≤0.22Kg。</p>	

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			22、热合时间 ≤ 1 秒。 23、消耗功率：工作： $\leq 250W$ ；待机： $\leq 10W$ 。 24、辐射防护安全性：确保高频 40.68MHz 工作下，辐射强度不超过 68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。 25、仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞。	
▲9	血小板恒温振荡保存箱		温控方式：双微处理机技术 温控范围： $22.0^{\circ}C \pm 2.0^{\circ}C$ 报警温度： $< 20^{\circ}C$ 、 $> 24^{\circ}C$ 振荡幅度： $50mm \pm 5mm$ 工作方式：连续往复（左右）、水平振荡 振荡频率：60 周 / 分钟 工作电源：单相三线 180V~240V 50HZ 300W 环境温度： $5^{\circ}C \sim 35^{\circ}C$ 存放面积： $\leq 270 \times 270 \times 35$ (mm) (宽 \times 深 \times 层高) 层数： ≥ 5 层 存放袋数：5~10 袋 外形尺寸： $\leq 510 \times 545 \times 700$ (mm) (宽 \times 深 \times 高) 重量： $\leq 60kg$ 采用双微处理机技术，循环风道，温度均匀，控温精确 制冷效果好； 具有备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换； 箱体采用整体聚胺酯隔热材料，厚度 $\geq 40mm$ ；热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、阻绝外来冷/热源； 对停电、传感器失灵、超温、停振等故障均能声光报警； 具有独立的振荡监测系统，实时监控振荡小车的运行； 连续运转无噪音，振荡平稳，性能优良； 底部四个万向脚轮，并带有自锁功能；	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			<p>箱体内部均采用不锈钢材料，易于清洁和消毒；</p> <p>优质的不锈钢抽屉式搁架，有效防止血小板滑落，且存取方便、易于清理；</p> <p>配备后备电池，可在断电情况下及时报警；</p> <p>采用 134a 环保制冷剂；</p> <p>体积小巧；</p> <p>通过省医疗器械检验所有关电磁兼容性（EMC）要求的检测。</p> <p>作为 II 类医疗器械管理，具有 II 类医疗器械注册证。</p>	
▲10	全自动生化分析仪		<ol style="list-style-type: none"> 1、操作系统：全中文图形化界面，7 英寸彩色高清触摸操作，方便工作人员操作； 2、分析项目：ALT、HGB，乳糜血识别，样品溶血四项联检，同时定量出四项结果； 3、通道：4 通道，可同时检测 4 个样本（每个样本检测 4 项）； 4、检测速度：循环检测，可任意添加样本； 5、样本量：全血 30ul； 6、波长：340nm—540nm； 7、分析方法：速率法，比色法、比浊法； 8、检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆； 9、加样系统：高精度吸样探针，机械臂全自动加样，无需手工加样； 10、液位感应：精准数字液位探测，随时跟踪报警功能； 11、恒温系统：反应区温控精度 37℃ ± 0.1℃，实时温度显示，需要的时间：3 分钟； 12、转氨酶试剂保护：标配制冷单元，转氨酶试剂在使用中始终在 2-8° C； 13、预装单人份试剂，无需现场配备无需预热即可使用； 14、重量：≤7kg. 方便携带； 15、占用台面空间(长×宽)：≤34cm×21cm。节省空间、方便台面放置； 16、工作环境温度：0-45℃； 17、抗颠簸设计、仪器能很好的适应在流动采血车上正常使用； 18、标配防滑提手，方便携带移动； 	1 套

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			19、电源：AC 220v/50Hz。	
▲11	医用血液冷藏箱		<p>1、门体：采用立式单门设计，大视角双层电加热玻璃发泡门体，自关门功能。</p> <p>2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在 $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ 范围内，控温精度 0.1°C。</p> <p>3、显示：LED 数码管显示，内温度恒定控制在 $2-6^{\circ}\text{C}$，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率 0.1°C。</p> <p>4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。</p> <p>5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。</p> <p>6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。</p> <p>7、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。</p> <p>8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>9、配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。</p> <p>10、压缩机：进口压缩机，节能低噪，使用寿命长。</p> <p>11、冷凝风机：进口冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。</p> <p>12、不锈钢内胆设计，防腐抑菌。</p> <p>13、门锁功能，防止随意开门。</p> <p>14、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。</p> <p>15、箱内 5 个高精度传感器，带防高温和防低温机械控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。</p> <p>16、单独电源开关设计，方便人员安全操作。</p> <p>17、箱内设置 LED 照明灯，外部独立灯开关。</p> <p>18、4 个搁架，4 个血管，2 个透明亚克力内门，可减小开门取血的冷量散失。</p> <p>19、具有医疗器械注册证。</p> <p>20、外部尺寸(mm)（宽*深*高）：$\leq 570*570*1550$</p> <p>21、有效容积$\geq 150\text{L}$。</p>	1 台

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
▲12		医用冷藏箱	<p>1、有效容积：外部尺寸$\leq 495\text{mm} \times 580\text{mm} \times 660\text{mm}$；内部尺寸$\geq 415\text{mm} \times 385\text{mm} \times 505\text{mm}$；有效容积$\geq 68\text{L}$，立式，可桌上放置；</p> <p>2、整体结构：采用 LBA 无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用 PS 吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；</p> <p>3、温度控制：箱内温度稳定在 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$，电脑板控温，LED 数字显示箱内温度，显示精度控制精度均为 0.1°C，显示板密码保护功能，保护参数不能随意更改，保证温度的一致性；</p> <p>4、核心组件：压缩机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，采用双直流风机，通过 12V 安全电压供电，使用更安全，性能更稳定；</p> <p>5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；</p> <p>6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷循环，保证箱内体温度均匀性$\leq 2^{\circ}\text{C}$，波动值$\leq 2^{\circ}\text{C}$；</p> <p>7、门体结构：采用真空双层钢化玻璃门体，采用铝合金门框，美观耐用，门体安装一体式门把手，开启更方便；门体采用电极式加热防凝露设计，32°C环温 85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见，门体具有自关门设计，防止开门后忘记关门；</p> <p>8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；</p> <p>9、合理布局：产品内部配有 2 层蘸塑搁架及 1 个储物筐，搁架高度可调整，储物空间按需调节；</p> <p>10、温度监控：产品配有一个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测；</p> <p>11、柜内照明：内设 12VLED 照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；</p> <p>12、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；</p> <p>13、停电报警：配备直流 12V 可充电锂电池，满容量可保障停电报警 8 小时；</p> <p>14、安全保障：门体上部带锁，储物更加安全；</p> <p>15、宽电压带：产品配备宽电压带，适合 $198 \sim 242\text{V}$ 电压下使用；</p> <p>16、固定移动：产品配备 4 个底脚，便于移动且固定方便。</p>	1 台
▲13		电子血压计	<p>检测方式：臂式</p> <p>工作模式：全自动</p>	1 台

序号	分项内容	分项名称	规格参数	数量
			加压方式：智能加压 测量精度：<5 毫米汞柱 测量范围：压力：0~299mmHg (0~39.9kPa) 记忆组数：≥14 组 脉搏数：40~180 次/分 电源类型：4 节 5 号电池或电源适配器 外包装尺寸（mm）宽≤103×高≤80×厚≤129m	

七、其他要求

1、献血屋内须配置供水系统，方便献血屋内用水需求；

照明：屋内照明系统齐全，亮度满足采血工作需要。

2、献血屋的墙体厚度为 $7.5\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ ，确保隔热保温，保温层要求使用聚氨酯环保材料，易清洗，有足够耐用度。

3、献血屋内外所有玻璃均采用高强度中空玻璃。

4、献血屋底部设置储物仓：2-3 个，前面不放。

①清洁工具仓：可存放拖把、水桶；

②电路控制仓：内设插座可供大型宣传活动用电，设有分路空气开关；

④储物仓：内设插座可供外接音箱、志愿者手机、血压计等用电；同时底部设有与车体一致的围板，保持美观效果。

★5、电路控制：

①储血冰箱、两块电子显示屏以及屋顶发光字电源须独立控制；

②电子显示屏、屋顶发光字、紫外线消毒灯可自动定时控制；

③含外接电源连接器、便携式电缆线盘、室内电器控制箱、开关插座、照明灯具、内置电源线路等；开关、插座参照船用要求；

④车内电器分路控制，独立开关；车内布线用防火防爆电缆线，所有电缆线应达到屋内负荷极限承载能力；

⑤施工用线不得破线破皮；屋内布线，应便于维修，不得封死、不得有接头；

⑥配电箱含漏电保护装置，可负载 60A，推荐品牌：天津梅兰日兰品牌、德力西、公牛。

★6、献血屋内所有桌椅台柜材质均要求为三聚氰胺板双饰面生态板，内层为实木颗粒，台面硬度大，耐磨，耐热，能抵抗酸、碱、油脂及酒精磨蚀。表面平整、不易变形，颜色鲜艳，易维护清洗。所用抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。供应商须提供由国家家具产品质量监督检验中心所出具的板材检测报告。检测项目须包含：人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、耐酸碱性、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧、耐光色牢度、表面胶合强度、金属拉手耐腐蚀性要求、柜类强度和耐久性测试、柜类稳定性测试、甲醛释放量以及重金属释放量。

★7、所有柜门开关均要求为内嵌式，钥匙等物体均不突于表面。所有柜体尺寸、式样、数量、制作、位置确定、安装、颜色等生产前必须经采购人确认。采购人可以根据实际需要进行调整，不另行增加相关费用。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)本项目对符合办法规定的小型 and 微型企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合办法规定的《中小企业声明函》(格式见第六章)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件及中小微企业划型标准(网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zcfg/gjfg/201608/t20160824_93179.html)自行填写。

(4) 若响应单位提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，

给予联合体 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣 2 分，评价结果为二星的扣 3 分，评价结果为一星的扣 4 分。

三、评标标准

项 目	评 分 标 准
价格 (30分)	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分 30 分，其他投标报价得分 = (评标基准价/其他投标报价) × 30 × 100%。(保留二位小数) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
技术参数 (30分)	投标人所投产品技术参数完全满足招标文件【技术参数】得 30 分。其中加“▲”项为关键技术参数，每有一项负偏离扣 1.2 分；扣完为止。
方案 (20分)	根据投标人提供的效果图及方案进行打分： 1、投标产品内部布局合理可行，得 5 分；较合理、可行，得 3 分；基本合理，得 1 分；存在实施难度或不提供不得分。 2、投标产品外观美观大方，得 5 分；较美观，得 3 分；美观性一般，得 1 分；不提供不得分。 3、投标产品的可移动性、移动方案科学、严谨、合理、可行，得 5 分；较合理、严密、描述较为详细，得 3 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、存在实施难度或不提供不得分。 4、投标人对本项目的运维方案、人员安排、故障解决方案合理可行，得 5 分；较合理、严密、描述较为详细，得 3 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、存在实施难度或不提供不得分。
业绩 (12分)	投标人 2019 年 1 月 1 日至今承担过与本项目类似的业绩，有一个得 2 分，满分 12 分。(以合同签订时间为准) 上述业绩： ①证明材料须同时提供项目合同、中标通知书（或中标公告网站截图），复印件加盖投标人公章，合同以及中标通知书原件（或中标公告网址现场登陆查看）现场核查，无原件（或网址错误）不得分。 ②未经过国内公开招投标(或竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式)的业绩，须同时提供该业绩的合同及与该项目对应的项目发票，复印件加盖投标人公章，合同以及发票原件现场核查，无原件不得分。
售后服务 (8分)	1、免费质保期在“项目需求”要求的基础上，每增加 1 年得 1 分，满分 5 分。 2、投标人承诺在接到采购人故障通知后，能在 30 分钟内响应，并且能在 4 小时内解决的，得 3 分；能在 1 小时内响应，并且能在 10 小时内解决的，得 1 分；其他不得分（提供承诺函原件）。

注：

(1) 评分标准中要求提供原件的，投标人须提供相关原件或公证件，否则与之对应项不得分。

(2) 响应文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件。

(3) 投标人提供的相关证明材料，如弄虚作假，根据《政府采购法》予以处罚。

(4) 上述原件或公证件等属于响应文件的组成部分，须在开标当天随投标响应文件一起在投标截止时间前同时递交，若有缺失，将导致对应项不得分且不允许在开标后补正。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

编 号：YZRXGK-2022122

投标人名称：

日 期：

投标主要文件目录

- 一、资格性和符合性检查响应对照表
- 二、资信证明文件
- 三、开标一览表
- 四、分项报价表
- 五、供货一览表
- 六、技术参数响应及偏离表
- 七、商务条款响应及偏离表
- 八、主要标的信息（中标后将公示）
- 九、疫情防控期间供应商承诺书
- 十、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

序号	资格性和符合性检查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
<u>1</u>			
<u>2</u>			
<u>3</u>			
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>	<u>招标文件中的其他实质性要求</u>		

二、资信证明文件要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 投标函(原件)

1.2 资格声明(原件)

1.3 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)

1.4 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)

1.5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月(2022年6月-2022年8月)缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6 投标人近三个月内任意一个月(2022年6月-2022年8月)依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.7 与上一条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告(复印件加盖投标人公章)

1.8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)

1.9 供应商信用承诺书(原件)

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)及《关于新冠肺炎防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》(苏财购(2020)19号)，本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业(中小微企业划型标准网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm；产品生产企业或提供服务/工程企业规模类型自测小程序：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>)。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标单位具备医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证(复印件加盖投标人公章)；

3.2 投标单位具备第二、第三类医疗器械经营备案凭证(复印件加盖投标人公章)；

3.3 所投产品的《医疗器械注册(备案)证》(复印件加盖投标人公章)。

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司(成立时间距开标时间不到1年)、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述1.5-1.7三项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

1、投标函格式

致：扬州仁信工程管理有限公司

根据贵方的 YZRXGK-2022122 号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们将被列入不良行为名单。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：_____年____月____日

2、资格声明

1、名称及其它情况：

(1) 投标人名称：

(2) 地址：_____ 邮编：

电话：_____ 传真：

(3) 成立和/或注册日期：

(4) 法定代表人：

(5) 实收资本：

(6) 近期资产负债表：（到 20 年 12 月 31 日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

甲方名称、联系人、联系方式

项 目 名 称

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：____年____月____日

（注：资格声明为格式文件，请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法定代表人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就 YZRXGK-2022122 号扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目 采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

被授权人签字：_____

联系电话（手机）：

单位名称：_____

授权单位盖章：_____

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

法定代表人身份证：

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____年___月___日

5、供货承诺书（格式）**供货承诺书**

（供应商名称）_____在此承诺：

本公司（单位）_____对本项目（_____）所提供的货物均为原厂全新合格品且生产日期不早于_____年__月__日。如所供之货物不符合前述承诺，本公司（单位）_____将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____

6、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本企业_____项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加扬州仁信工程管理有限公司的（项目名称）采购活动，提供的货物**全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员（根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》定义）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、声明函应涵盖本项目（分包）**所有货物/服务/工程**。

3、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：

（1）划型标准中个别行业不涉及的指标未填写或填写错误；

（2）声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的。

4、供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的属于明显不实的声明函，将不予认定有效，也不作为虚假资料情形认定。

5、企业声明函请完整填写，中标/成交后将公示。供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标/成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、母（总）公司应当将分公司、控股子公司数据合并后划分规模类型；分公司不能独立划型；子公司如为独立法人，可单独划型。

7、根据《统计上大中小微型企业划分标准》，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

投标货物名称	投标总报价
	大写： 小写：（人民币）
主要货物制造商及产地	
货物制造商是否为小微企业	

日期：____年__月__日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

四、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

1	2	3	4
货物名称及规格、型号	数量	单价	总价
合计			

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

货物名称	型 号	产地	数量	交货期

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

序号	招标要求	投标响应	超出、符合或偏离	原因

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
交货时间	合同签订后__天内		
交货方式			
交货地点			
付款方式			
投标货币			
备品备件及耗材等要求			
其他			

法定代表人或授权代表签字：

八、主要标的信息（中标后将公示）

项目名称：扬州市中心血站高邮、宝应献血屋及配套医用设备采购项目

项目编号：YZRXGK-2022122

投标人全称（加盖公章）：

投标人地址：

货物类
名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

九、疫情防控期间供应商承诺书

本单位承诺：

- 一、本单位经办人苏康码或健康码均为绿码、行程码（扬城码）正常；
- 二、本单位将严格管理招投标经办人员防疫工作落实情况；
- 三、本单位将严格要求工作人员做好个人防护措施，服从扬州仁信工程管理有限公司疫情防控各项规范，做好防疫措施，从指定区域通道进出，不得前往招投标现场以外的其他区域。如本单位违反疫情防控规定，造成疫情传播等重大后果的，由本单位承担法律责任。

承诺人（单位盖章）：_____

2022 年 月 日